

# Как перейти с ПО Biosmart-Studio v4 на ПО Biosmart-Studio v6?

Среднее время решения: 30 мин.

Сложность: (Начальная)

Дата обновления: 07.11.2025


Инструмент **Импорт данных из Biosmart-Studio v4** предназначен для удобства переноса данных о сотрудниках (в том числе биометрических данных) из БД Biosmart-Studio v4 в БД Biosmart-Studio v6.

**i** Для успешного импорта, перенесите папку BioSmart-Studio\_v4.0 на компьютер, где развернута серверная часть Biosmart-Studio v6.

## Подготовка к импорту данных

Для выполнения импорта данных из Biosmart-Studio v4 в Biosmart-Studio v6 выполните следующие подготовительные шаги:

1. Скачайте и установите драйвер [Access Database Engine 2016](#).
2. Запустите **Администратор источника данных ODBC (64-разрядная версия)**.
3. Создайте новый источник данных. Для этого перейдите во вкладку **Системный DSN**, нажмите кнопку **Добавить**.
4. В списке драйверов выберите **Microsoft Access Driver (\*.mdb)** и нажмите **Готово**.
5. В открывшемся окне укажите **Имя источника данных: BSA\_base64**, нажмите кнопку **Выбрать** и укажите путь до файла с БД Biosmart-Studio v4 ("C:\Program Files (x86)\ProSoft-Systems\BioSmart-Studio\_v4.0\Base\BSA\_base.mdb"), нажмите кнопку **ОК**.
6. Нажмите кнопку **Дополнительно** и заполните поля **Имя (BSA)** и **Пароль (BSA)**, нажмите кнопку **ОК**.
7. Сохраните изменения в окне **Установка драйвера ODBC для Microsoft Access** нажав кнопку **ОК**.

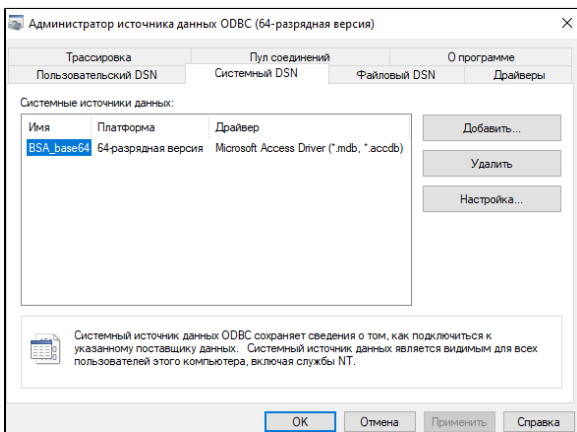


8. Предоставьте полные права группе **Пользователи** на папку "C:\Program Files (x86)\ProSoft-Systems\BioSmart-Studio\_v4.0\Base".

**i** Данная версия более не поддерживается.  
Информация не обновляется.

**i** ПО Biosmart-Studio v4.2.21.11 (при использовании настольного сканера FS-80 или без использования сканера).

ПО Biosmart-Studio v4.2.22.1 (при использовании настольного сканера FS-80H).

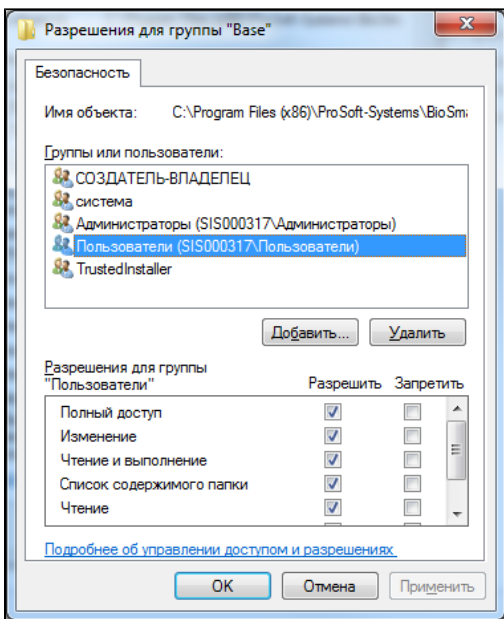


9. Подготовка к импорту данных завершена.

#### Импорт данных

Для того чтобы импортировать данные о сотрудниках из БД Biosmart-Studio v4 в БД Biosmart-Studio v6 перейдите в **Основном меню** в раздел **Инструменты** → **Импорт данных из Biosmart-Studio v4**.

Запустится мастер импорта данных, нажмите **Далее**.

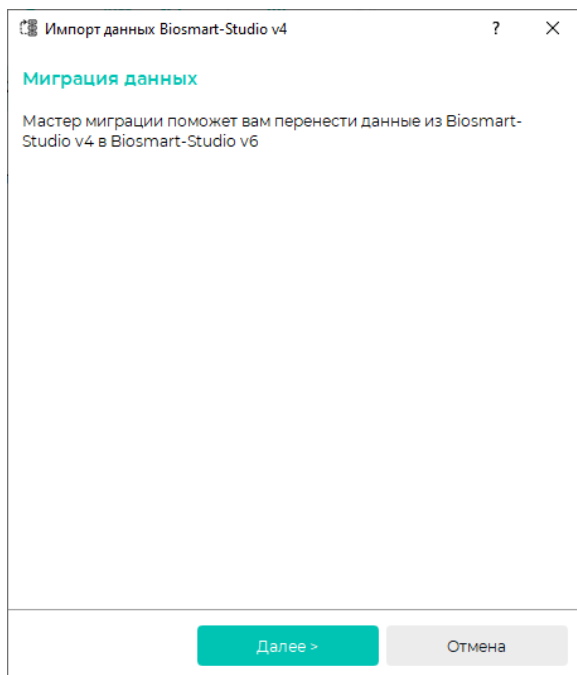

В окне настройки параметров укажите путь к папке с установленной Biosmart-Studio v4, а также параметры подключения к базе данных. Нажмите **Далее**.

Импорт данных Biosmart-Studio v4

### Настройка параметров

Проверьте каталог установки и параметры подключения к СУБД  
Biosmart-Studio v4

Параметры установки

Каталог установки  
D:\Biosmart Studio v4.0

Параметры подключения

Источник данных ODBC  
BSA\_base

Имя пользователя  
BSA

Пароль  
•••

< Назад    Далее >    Отмена

Откроется окно настройки параметров. Следуйте указаниям мастера импорта данных. По окончании импорта в структуре предприятия появится предприятие "Данные студии 4".