
Быстрый старт BioSmart PalmJet 2

В разделе описан минимальный необходимый перечень настроек, которые следует выполнить для начала работы со считывателем **BioSmart PalmJet 2**.

Приступать к настройке считывателя следует после монтажа (см. раздел Монтаж) и подключения (см. раздел Подключение).


Выполните настройку в следующем порядке:

1. Добавьте контроллер **BioSmart UniPass Pro 2** в ПО Biosmart-Studio v6 и измените сетевые параметры в соответствии с конфигурацией используемой сети. Подробный порядок действий описан в Руководстве по эксплуатации контроллера в разделе Быстрый старт BioSmart UniPass Pro 2.
2. Добавьте считыватель в ПО Biosmart-Studio v6.
   Прейдите в раздел **Устройства** → выберите контроллер → нажмите кнопку **Управление считывателями**.

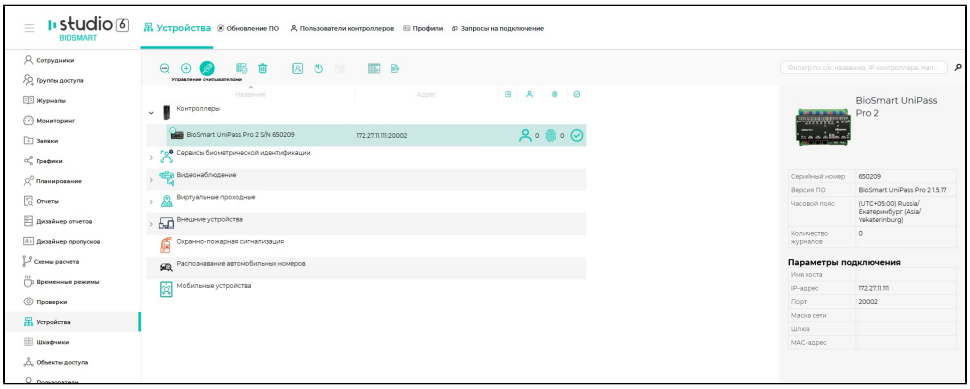


В окне **Мастер управления считывателями** нажмите кнопку **Найти**. Отобразится список всех доступных для подключение считывателей.


Выберите подключенный считыватель и нажмите кнопку **Добавить**, затем **Завершить**.

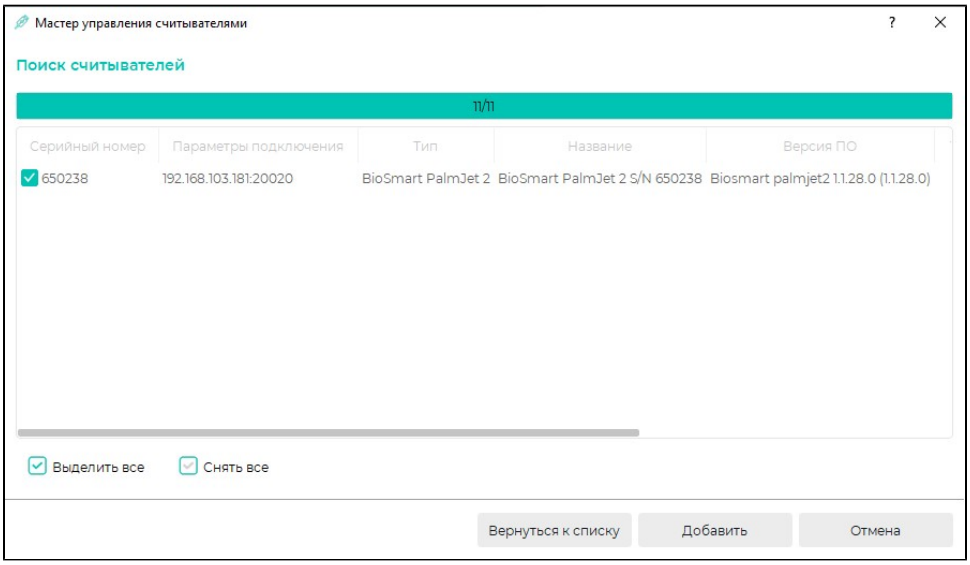

Добавленный считыватель появится в списке устройств.

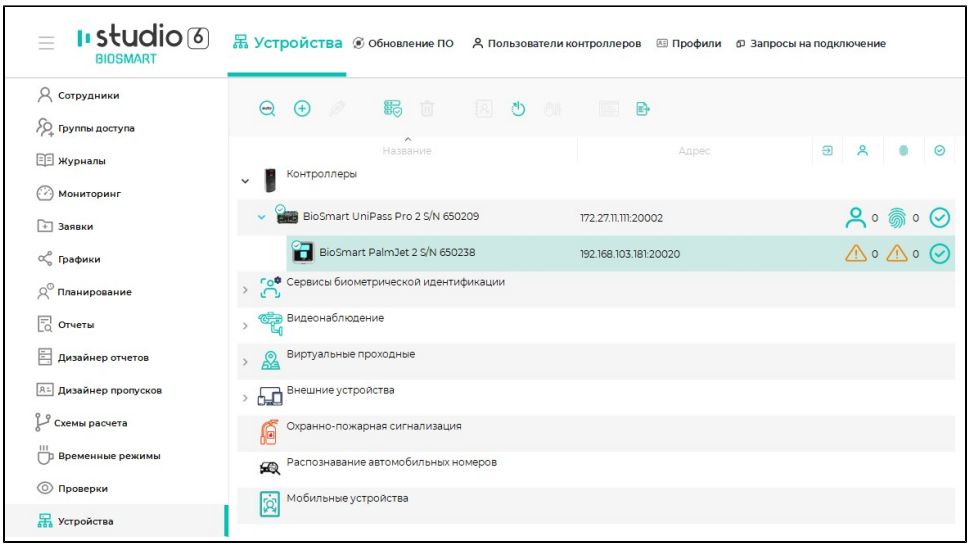


3. Если считыватели не найдены, проверьте сетевые настройки согласно разделу Сетевые настройки BioSmart PalmJet 2.
4. Перейдите в раздел **Группы доступа →** выберите группу доступа → отметьте считыватель и нажмите кнопку **Сохранить**.

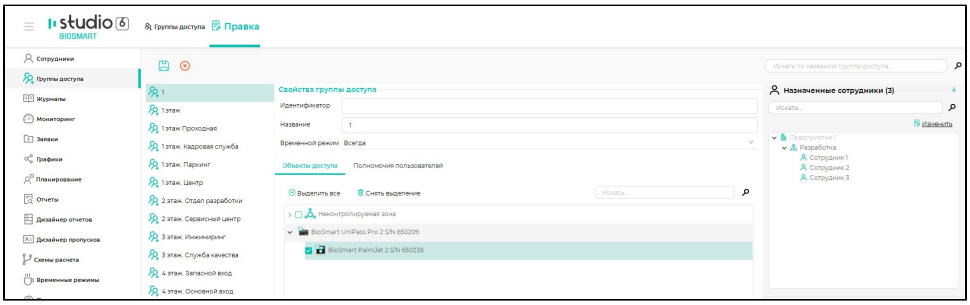

5. Зарегистрируйте биометрические шаблоны вен ладони.

Перейдите в раздел **Сотрудники** → выберите сотрудника → нажмите кнопку **Сканировать → Ладони.**

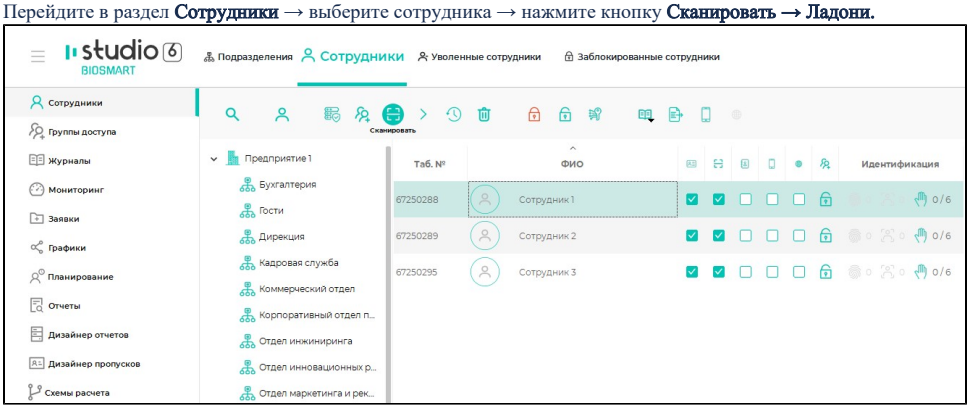


В качестве устройства, с которого будет производиться регистрация рисунка вен ладоней, из выпадающего списка выберите **BioSmart PalmJet 2**.

> Перед началом регистрации шаблона убедитесь, что на считыватель установлен держатель ладони, входящий в комплект поставки. Это необходимо для создания биометрических шаблонов наилучшего качества. Чем выше качество биометрических шаблонов, добавленных при регистрации сотрудника, тем точнее будет осуществляться идентификация.

Выберите ладонь, которая будет регистрироваться, и нажмите кнопку  над изображением этой ладони.

Появится сообщение: **Приложите ладонь к сенсору**.

Если в течение одной минуты ладонь не появится перед считывателем, то регистрация шаблонов будет отменена. Прервать процесс регистрации в любой момент можно с помощью кнопки **Отменить.**

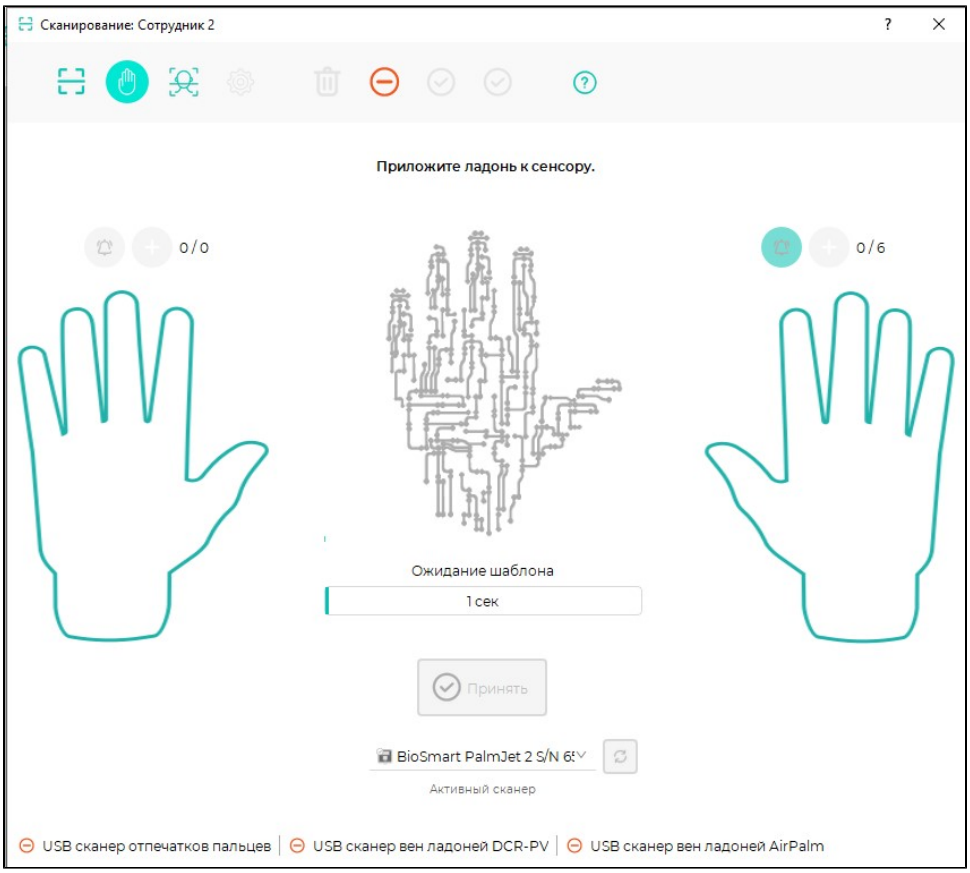

После появления на экране считывателя сообщения **Enroll** необходимо поднести ладонь к сканеру вен в соответствии с нижеперечисленными правилами:


- ладонь раскрыта естественным образом, большой палец отодвинут от ладони;
- центр ладони располагается над центром биометрического сканера;
- запястье лежит на нижней части держателя ладони.

Для создания шаблонов необходимо подносить ладонь к сканеру и не убирать, пока не будет создано шесть шаблонов. При успешной записи каждого шаблона на считывателе будет срабатывать зеленый сигнал светодиода и звуковой сигнал.

Если ладонь неверно расположена относительно биометрического сканера, то на экране считывателя будут появляться подсказки "**DOWN ↓**" (опустить ладонь вниз) и "**UP ↑**" (поднять ладонь наверх).

После завершения сканирования на считывателе отобразится сообщение **Success,** сработает зеленый сигнал светодиода и звуковой сигнал.

Если совпадений с шаблонами других сотрудников не найдено, появится сообщение с запросом на подтверждение сохранения шаблонов. Нажмите кнопку **Да**.

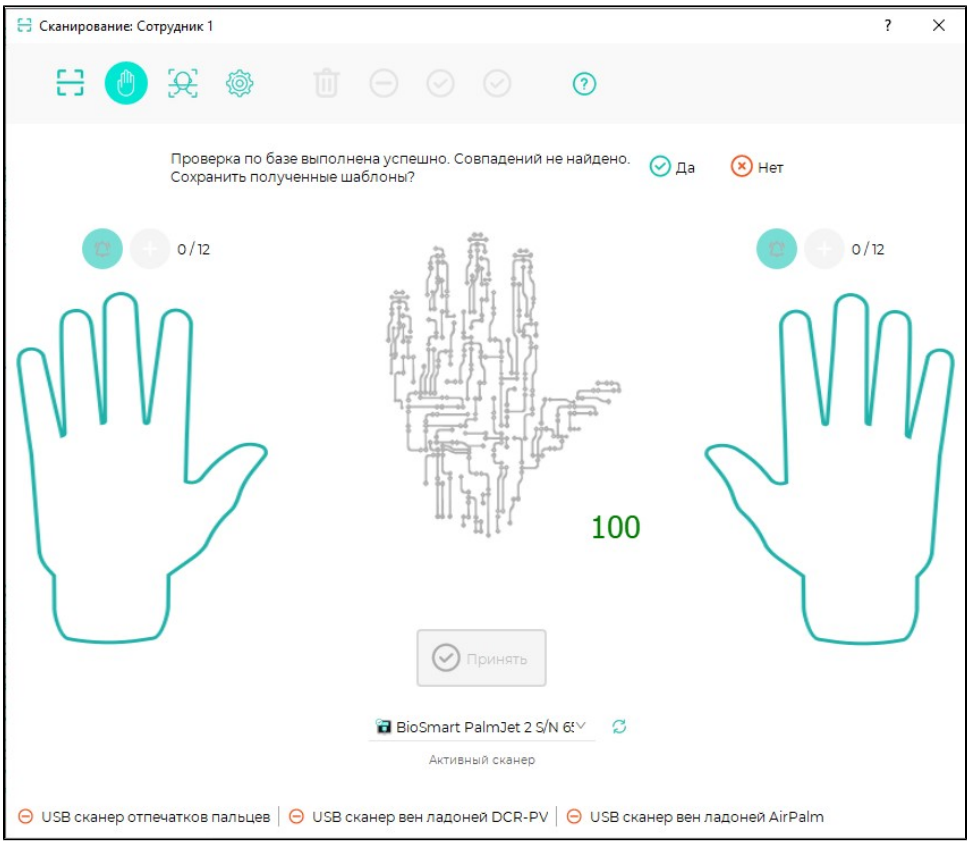

Если совпадения обнаружены, то появится сообщение о наличии совпадений биометрических данных сотрудников, сохранение полученных шаблонов будет запрещено.

После успешной регистрации шаблонов вен ладоней в свойствах сотрудника будет отображаться наличие шаблонов вен ладоней и их количество.